

## 체외진단의료기기

### 1. 품목정보

|          |                            |                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 허가(신고)번호 | 체외 수허 12-2351 호            |                                                                                                                                                              |
| 품 목 명    | 종양표지자면역검사시약                |                                                                                                                                                              |
| 분류번호(등급) | K02080.01(3)               |                                                                                                                                                              |
| 모 델 명    | μ TASWako AFP-L3 Control H |                                                                                                                                                              |
| 포장단위     | 용기 등의 기재사항 참조.             |                                                                                                                                                              |
| 제조번호     | 용기 등의 기재사항 참조.             |                                                                                                                                                              |
| 제조연월     | 용기 등의 기재사항 참조.             |                                                                                                                                                              |
| 수입원      | 상 호                        | 아산제약(주)                                                                                                                                                      |
|          | 주 소                        | 서울특별시 동대문구 청계천로 485                                                                                                                                          |
|          | 전화번호                       | 02-3290-5700                                                                                                                                                 |
|          | F a x                      | 02-3290-5750                                                                                                                                                 |
| 제조원      | 상 호<br>(국가)                | 제조사(본사) : FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation(일본)                                                                                                        |
|          |                            | 제조사(공장) : FUJIFILM Healthcare Manufacturing Corporation Mie Office(일본)<br>제조사(공장) : FUJIFILM Healthcare Manufacturing Corporation Mie Office Komono Site(일본) |

### 2. 구성

| 번호 | 명칭                         | 세부구성      |
|----|----------------------------|-----------|
| 1  | μ TASWako AFP-L3 Control H | CTR H     |
|    |                            | CTR H용 홀더 |

### 3. 사용목적

본 제품은 μ TASWako AFP-L3 키트로 측정된 AFP-L3와 AFP의 측정치가 표시되어 있다. μ TASWako AFP-L3에 따른 AFP 및 AFP-L3 측정의 정도관리에 사용한다.

### 4. 표시치의 설정

본 제품은 National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) Cond : AFP. The 1st International Standard for ALPHAFETOPROTEIN을 1차 표준물질로 하여 μ TASWako AFP-L3로 설정한 AFP-L1 및 AFP-L3의 표시치가 기재되어 있다.

### 5. 사용방법

그대로 사용한다.

개봉 후에는 되도록 빨리 사용하고, 사용 후에는 건조하지 않도록 밀봉하여 2~10℃에 보관한다.


### 6. Calibrator의 바코드 관리

μ TASWako AFP-L3 시약 전용 Control H의 정보를 바코드로 관리할 수 있다. 부속품인 바코드홀더(해당 로트 전용)를 사용하여 Calibrator 정보를 자동으로 입력할 수 있다.

#### <바코드홀더 사용방법>

아래 그림과 같이 Control을 넣었던 샘플컵\*을 이와 상응하는 바코드홀더의 위에 놓는다.

[그림]

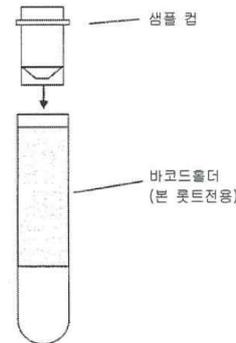

자세한 사항은 μ TASWako i30 사용설명서를 참고한다.

\* 바코드 부착홀더에 설치하는 샘플컵은 별도판매구성품(코드 452-00501)이다.

### 7. 사용 시 또는 취급 시 주의사항

#### 7.1 사용 시 주의사항

- 올바른 결과를 얻지 못할 수 있으므로 로트가 다른 바코드홀더를 사용하지 않는다.
- Control 사용이 끝날 때까지 바코드홀더를 버리지 않는다.
- 본 제품은 본 설명서에 기재된 사용방법에 따라 사용해야 한다. 또한, 측정시약의 사용설명서로 병행하여 참고한다.
- 본 제품은 지정된 조건에서 보관해야 하고 사용기한이 지난 것을 사용하지 않는다.
- 본 제품은 본 설명서에 기재된 사용목적 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
- 본 제품의 용기를 다른 목적으로 사용하지 않는다.

#### 7.2 위험방지를 위한 주의사항

- 본 제품이 눈이나 입에 들어가거나 피부에 접촉한 경우 다량의 물로 씻어내고 필요 시 의사의 진단을 받는다.
- 본 제품에는 사람유래성분이 포함되어 있어 바이러스 감염 등의 위험성이 있다. 따라서 검체와 같이 주의해서 취급한다. 또한, 본 제품은 HBs 항원, HIV-1/HIV-2항체 및 HCV항체검사를 실시하여 음성인 것이 확인되었다.

#### 7.3 폐기 시 주의사항

- 폐기 시 폐기물 처리 및 청소관련 법률(폐기물처리법), 배수기준에 따라 적절한 방법으로 폐기한다.

### 8. 저장방법 · 사용기간

- 저장방법 : 2~10℃ 보관
- 사용기간 : 제조 후 1년 2개월 간

### 9. 포장단위

| 코드번호      | 제품명                        | 포장단위    |
|-----------|----------------------------|---------|
| 466-49401 | μ TASWako AFP-L3 Control H | 2mL x 4 |

### 10. 별도판매구성품

| 코드번호      | 제품명   | 포장단위   |
|-----------|-------|--------|
| 452-00501 | 샘플컵-S | 1,000개 |